

	Anforderung an Prozesse	A00-09
	Konformität von Prüfergebnissen	Datum / Ausgabe 24.03.2025 Seite 1 von 1 Revisionsstand 1


Diese Entscheidungsregel gilt in Ergänzung zu den AGB bzw. zum Kundenauftrag.

Gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Kapitel 7.1 und 7.8.6 besteht bei Kundenwunsch die Notwendigkeit eine Regel zu vereinbaren, wie Messunsicherheiten bei Aussagen zur Konformität von Prüfergebnissen in Berichten zu berücksichtigen sind. Die dabei angewandte Entscheidungsregel muss dokumentiert werden.

Bei der PWT GmbH werden die im Folgenden dargestellten Entscheidungsregeln angewendet:

1. Sofern die Entscheidungsregel in Normen oder Spezifikationen der beauftragten Prüfungen festgelegt ist, gelten diese als mit dem Kunden vereinbart.
2. Sofern der Kunde eine andere Entscheidungsregel bzw. eine eigene Anforderung an das Prüfergebnis benötigt, muss er diese separat schriftlich mit der Auftragsanfrage / dem Auftrag mitteilen.
3. Sofern die oben genannten Punkte 1. und 2. nicht vorliegen, wird grundsätzlich die Entscheidungsregel gemäß ILAC G8 Kapitel 4.2.1 angewandt. Bei der Konformitätsaussage werden keine Messunsicherheiten berücksichtigt. Die Anforderung ist erfüllt, wenn der Messwert kleiner oder gleich der Toleranzgrenze ist.

Entscheidungsregel:

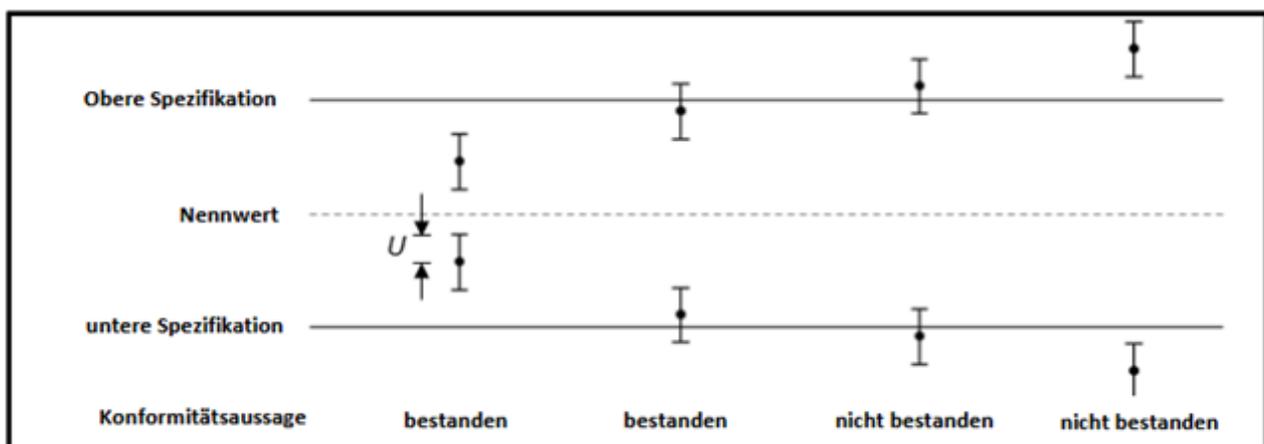

$U = 95\%$ erweiterte Messunsicherheit

Abbildung 1: grafische Darstellung einer binären Aussage – einfache Akzeptanz